


# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

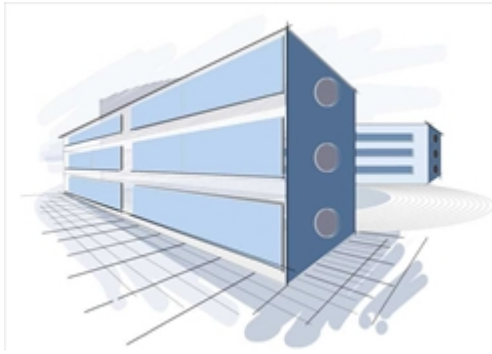

Projekt

**K237186\_KOGRowi\_Sonographie**

Bauvorhaben

**KOR07/2024**

**Ersatzbeschaffung Ultraschallgeräte KOG**

-

-

Leistung (LV)

**03**

**VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes auf der Vergabeplattform.

Vergabevorgang (Art der Ausschreibung)

Ausschreibung nach VOL/A

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten o. Anlage(n)

**Seiten: 25**

Leistungsverzeichnis\_BM 1 Seite

## Angebotssumme in EUR

**Angebotssumme, Netto:** .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

**Angebotssumme, Brutto:** .....

Angebotsabgabe

.....  
Anbieter - Datum, Ort

Stempel

.....  
Anbieter - Unterschrift

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.

<b>03      LV      VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
<b>01</b>	<b>Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin</b>	<b>3</b>
<b>02</b>	<b>Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal</b>	<b>11</b>
<b>03</b>	<b>Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde</b>	<b>18</b>
	<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>	<b>25</b>

03	Titel	<b>VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch</b>		
01	Titel	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin</b>			
	<p><b>Vorhabenbeschreibung</b></p> <p>Im Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch soll ein Sonographiegerät in der Kinderklinik ersetzt werden.</p> <p><b>Allgemeines</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei allen angebotenen Produkten handelt es sich um Neuware oder Demogeräte, nicht älter als sechs Monate mit allen aktuellen Prüfungen (STK)</li> <li>• alle angebotenen Komponenten sind kompatibel und dürfen zusammen betrieben werden</li> <li>• alle angegebenen Preise beinhalten die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einweisung und sämtliches Zubehör, das zum Betrieb benötigt wird</li> <li>• Die angebotenen Produkte bzw. Komponenten entsprechen den Anforderungen des Medizinproduktrecht-Durchführungsgesetz (MPDG)</li> <li>• Alle Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, Normen (wie IEC 60601-1-1, 60601-1-2, 60601-1-8) etc., die den Leistungsgegenstand betreffen, sind in ihrer gültigen Fassung zwingend einzuhalten</li> <li>• Der Bieter erfüllt die Erfordernisse der DIN EN ISO 9001</li> <li>• Der Bieter erfüllt die Erfordernisse der DIN EN ISO 13485</li> </ul> <p>Alle angebotenen Elemente, Materialien müssen für den Benutzer gesundheitlich unbedenklich sein. Beim Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln bleiben die Oberflächen mechanisch und chemisch stabil, es entstehen keine gesundheitsschädlichen Dämpfe. Bitte fügen Sie jeweils eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p> <p><b>Auswertung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Mindestanforderungen müssen erfüllt werden. Eine Nichterfüllung führt zum Ausschluss des Bieters vom weiteren Vergabeverfahren.</li> <li>• Neben den Mindestanforderungen wird in einer Probestellung die Handhabbarkeit von Soft- und Hardware des angebotenen Gerätes sowie die Bildqualität bewertet. Dieses Nutzervotum fließt ebenfalls in die Gesamtwertung ein.</li> <li>• Die Punkteverteilung und Gewichtung der einzelnen Kriterien entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bewertungsmatrix.</li> </ul>			
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

03	LV	<b>VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch</b>		
01	Titel	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.1</b>	<p><b>Grundgerät</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chirurgie</li> <li>• Pädiatrie/Kinderdiagnostik:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– offene Fontanelle</li> <li>– Säuglingshüfte</li> <li>– Herzuntersuchungen</li> <li>– oberflächliche Weichteile</li> <li>– Abdomen</li> <li>– Harntrakt</li> <li>– Refluxdiagnostik/ Kontrast</li> </ul> </li> <li>• mobil/fahrbar             <ul style="list-style-type: none"> <li>– geräuscharme Räder</li> <li>– zwei feststellbare Räder</li> </ul> </li> <li>• digitales, hochauflösendes RealTime-Triplex-System</li> <li>• intuitive Bedienphilosophie: Bedienoberfläche ist mit einer aktuellen Windowsoberfläche vergleichbar</li> <li>• mind. Windows 10 embedded System</li> <li>• bedienbar über Touchscreen und Hardkeys</li> <li>• ergonomische Bedienkonsole höhenverstellbar und schwenkbar</li> <li>• alle Oberflächen abwischbar und desinfizierbar</li> <li>• mind. 4 Sondenanschlüsse (parallel belegbar/verwendbar) und einen Stiftsondenanschluss</li> <li>• Gelwärmer</li> <li>• hochauflösender Farbmonitor (mind. 21")             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Größe des Farbmonitors: '.....' "</li> </ul> </li> <li>• EKG (mind. 3 Ableitungen)</li> <li>• SVHS-Ausgang</li> <li>• DVI-Anschluss</li> <li>• mind. 1 USB-Anschluss</li> <li>• Drucker (schwarz/weiß)</li> <li>• WLAN-fähig</li> <li>• Akkubetrieb zur Pufferung bei Standortwechsel des Gerätes innerhalb der Station</li> <li>• Das Gerät muss in der entsprechenden Abteilung zur Probe gestellt werden. Der Termin zur Probestellung wird über die Vergabeplattform eVergabe angefragt und vergeben. Die Probestellung muss bis zum 20. September 2024 erfolgt sein. Das Protokoll zur Probestellung ist den Ausschreibungsunterlagen beigefügt und wird vor Ort ausgefüllt. Das ausgefüllte Protokoll ist Bestandteil der Angebotsunterlagen.</li> </ul> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

03	LV	<b>VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch</b>		
01	Titel	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p><b>Software/Anbindung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Power-Doppler</li> <li>• PW, CFI/CFM (Farb-)Doppler-Modi</li> <li>• automatische Dopplerkalkulation</li> <li>• B-Bild in mind. 256 Graustufen</li> <li>• Abtastformate:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Parallel Scan</li> <li>– Convex Scan</li> <li>– Sektor Scan</li> <li>– Trapez Scan</li> <li>– Panorama Scan</li> </ul> </li> <li>• Schallkopftechniken:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– linear array</li> <li>– convex array</li> <li>– sector phased array</li> </ul> </li> <li>• DICOM-Schnittstellen/DICOM-Anbindung             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Print</li> <li>– Storage</li> <li>– Worklist</li> <li>– Query / Retrieve</li> <li>– SR</li> </ul> </li> <li>• Applikationsspezifische Bildeinstellungen</li> <li>• Möglichkeit der Programmierung anwenderdefinierter Berechnungen, Piktogramme und Messfunktionen für die genannten medizinischen Bereiche</li> <li>• Möglichkeit einen Barcodescanner anzuschließen</li> <li>• Rausch- und Artefaktunterdrückung             <ul style="list-style-type: none"> <li>– automatische Gewebeoptimierung</li> <li>– automatische Farboptimierung</li> <li>– automatische Dopplerspektrumoptimierung</li> </ul> </li> <li>• Möglichkeit der Einbindung (DICOM) in das vorhandene Programm Orbis (Fa. Dedalus)</li> <li>• integriertes digitales Patientenarchiv</li> <li>• Bilddaten sind für Nachuntersuchungen schnell erreichbar und können retrospektiv optimiert werden</li> <li>• Möglichkeit der internen Speicherung von Einzelbildern und Bildfolgen im Falle eines IT-Ausfalls (mind. 500 GB)</li> </ul> <p>Notwendiges Zubehör (z.B. spezielle Sondenhalter) ist für alle obligatorisch angefragten Positionen mitzuliefern.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einweisung des Funktionspersonals</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Dauer der Einweisung:     '.....'</p> <p style="margin-left: 40px;">Umfand der Einweisung:    '.....'</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch</b>		
01	Titel	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung einer KV-Meldung</li> <li>• Elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung nach EN 60601-1 ja/nein: '.....'</li> <li>• CE-Zeichen mit Angabe der benannten Stelle: '.....'</li> <li>• Lieferzeit ca. '.....' Wochen (max. 16 Wochen)</li> </ul> <p>Betriebssystemsoftware (deutschsprachig): '.....'</p> <p>Gerätetyp: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p>	<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>***Bedarfspos.</b>				
<b>01.2</b>	<p><b>Fußschalter</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußschalter zur Bedienung während einer Untersuchung von Säuglingen</li> </ul>	<b>1 St</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>01.3</b>	<p><b>Linearschallkopf 11 MHz</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenz: 11 MHz</li> <li>• inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals</li> </ul> <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</li> </ul>	<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch
01	Titel	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
01.4	<p><b>Mikrokonvex - Schallkopf 3-10 MHz</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenz 3-10 MHz</li> <li>• inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals</li> <li>• für Abdomen und Fontanelle</li> </ul> <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>	<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
01.5	<p><b>Convexschallkopf 3-5 MHz</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenz 3-5 MHz</li> <li>• inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals</li> </ul> <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>	<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
01.6	<p><b>Sektorschallkopf groß 3-5 MHz</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenz 3-5MHz</li> <li>• inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals</li> </ul> <p>Typ: '.....'</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch
01	Titel	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	<p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>	1 St	EP.....	GP .....
<b>01.7</b>	<p><b>Sektorschallkopf klein 10-12 MHz</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenz 10-12 MHz</li> <li>• inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals</li> <li>• für Untersuchungen der Fontanelle geeignet</li> </ul> <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>	1 St	EP.....	GP .....
<b>01.8</b>	<p><b>Hockey-Stick Schallkopf 10-18 MHz</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenz: 10 - 18 MHz</li> <li>• für Untersuchungen im Inkubator</li> <li>• inkl. Lieferung, Installatin und Einweisung des Funktionspersonals</li> </ul> <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>	1 St	EP.....	- Nur EP -
<b>01.9</b>	<p><b>Garantieverlängerung</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <p>Garantieverlängerung für max. 5 Jahre Bitte geben Sie nachfolgend die Kosten für jedes einzelne Jahr</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....



# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch
01	Titel	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	der Garantieverlängerung an:			
	1. Jahr: '.....'			
	2. Jahr: '.....'			
	3. Jahr: '.....'			
	4. Jahr: '.....'			
	5. Jahr: '.....'			
		<b>1 psch</b>		GP .....
	<b>Wartung/Service (Information)</b>			
	<b>Wartung:</b>			
	• jährliche Kosten für einen Vollwartungsvertrag: '.....'			
	• Wartungsturnus: '.....'			
	<b>Erreichbarkeit/ Verfügbarkeit</b>			
	<b>Service/Support</b>			
	• Erreichbarkeit werktags:			
	von '.....' Uhr			
	bis '.....' Uhr			
	• für einen Servicevertrag zu Grunde gelegte werktägliche Arbeitszeit			
	von '.....' Uhr			
	bis '.....' Uhr			
	• telefonische Rückmeldung:			
	• innerhalb '.....' Stunde(n)			
	• Reaktionszeit Techniker vor Ort: '.....'			
	• Dauer Ersatzteillieferung werktags: '.....'			
	• Bemerkungen des Bieters:			
	'.....'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch</b>		
01	Titel	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p style="text-align: center;">'.....'</p> <p style="text-align: center;">'.....'</p> <p><b>Fernwartung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kann die Möglichkeit zur Fernwartung vorgehalten werden?</li> </ul> <p>ja/nein      '.....'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn ja, bitte geben Sie die Kosten pro Stunde/pro Einsatz an: '.....'</li> </ul> <p><b>Einzelkosten Instandsetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kosten Service-Techniker pro Stunde</li> </ul> <p>werktags:    '.....' € brutto</p> <p>Sonn-/feiertags:    '.....' € brutto</p> <p>Bemerkungen des Bieters:</p> <p>'.....'</p> <p>'.....'</p> <p>'.....'</p>			
<b>Summe Titel 01</b>		<b>Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin, Netto: .....</b>		

03	Titel	<b>VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch</b>		
02	Titel	Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02</b>	<b>Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal</b>			
	<p><b>Vorhabenbeschreibung</b></p> <p>Im Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch soll ein Sonographiegerät für die Anästhesie des OP-Saals ersetzt werden.</p> <p><b>Allgemeines</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei allen angebotenen Produkten handelt es sich um Neuware oder Demogeräte, nicht älter als sechs Monate mit allen aktuellen Prüfungen (STK)</li> <li>• alle angebotenen Komponenten sind kompatibel und dürfen zusammen betrieben werden</li> <li>• alle angegebenen Preise beinhalten die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einweisung und sämtliches Zubehör, das zum Betrieb benötigt wird</li> <li>• Die angebotenen Produkte bzw. Komponenten entsprechen den Anforderungen des Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG)</li> <li>• Alle Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, Normen (wie IEC 60601-1-1, 60601-1-2, 60601-1-8) etc., die den Leistungsgegenstand betreffen, sind in ihrer gültigen Fassung zwingend einzuhalten</li> <li>• Der Bieter erfüllt die Erfordernisse der DIN EN ISO 9001</li> <li>• Der Bieter erfüllt die Erfordernisse der DIN EN ISO 13485</li> </ul> <p>Alle angebotenen Elemente, Materialien müssen für den Benutzer gesundheitlich unbedenklich sein. Beim Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln bleiben die Oberflächen mechanisch und chemisch stabil, es entstehen keine gesundheitsschädlichen Dämpfe. Bitte fügen Sie jeweils eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p> <p><b>Auswertung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Mindestanforderungen müssen erfüllt werden. Eine Nichterfüllung führt zum Ausschluss des Bieters vom weiteren Vergabeverfahren.</li> <li>• Neben den Mindestanforderungen wird in einer Probestellung die Handhabbarkeit von Soft- und Hardware des angebotenen Gerätes sowie die Bildqualität bewertet.</li> </ul>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

03 02	LV Titel	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Dieses Nutzervotum fließt ebenfalls in die Gesamtwertung ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Punkteverteilung und Gewichtung der einzelnen Kriterien entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bewertungsmatrix.</li> </ul>				Übertrag: .....
02.1	<p><b>Grundgerät</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur Durchführung von Untersuchungen an : <ul style="list-style-type: none"> <li>peripheren Nerven</li> <li>Venen-/Arterien</li> <li>Abdomen</li> <li>Echo-/Echo TEE</li> </ul> </li> <li>Frequenzbereich 1 MHz bis 20 MHz</li> <li>mobil/fahrbar für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen OP-Räumen der Station <ul style="list-style-type: none"> <li>mit geräuscharmen Rädern</li> <li>mind. zwei Räder feststellbar</li> </ul> </li> <li>interner Akku mit mind. 1,5 h Laufzeit bei Schallaktivität Laufzeit des Akkus: '.....' h</li> <li>digitales Farbtuplex-System</li> <li>intuitive Bedienphilosophie</li> <li>tiefenabhängige Steuerung der Sondenfrequenz vorhanden</li> <li>Farbmonitor/Touchscreen mind. 17" , dreh-, und kippbar</li> <li>ergonomische Bedienkonsole höhenverstellbar</li> <li>Sonden möglichst weit oben angebracht</li> <li>alle Oberflächen abwischbar und desinfizierbar</li> <li>mind. 3 Sondenanschlüsse (parallel belegbar/verwendbar)</li> <li>intelligentes Kabelmanagement</li> <li>mind. 1 USB-Anschluss</li> <li>Drucker (schwarz/weiß)</li> <li>Das Gerät muss in der entsprechenden Abteilung zur Probe gestellt werden. Der Termin zur Probestellung wird über die Vergabeplattform eVergabe angefragt und vergeben. Die Probestellung muss bis zum 20. September 2024 erfolgt sein. Das Protokoll zur Probestellung ist den Ausschreibungsunterlagen beigelegt und wird vor Ort ausgefüllt. Das ausgefüllte Protokoll ist Bestandteil der Angebotsunterlagen.</li> </ul> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>			
<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch</b>		
02	Titel	Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p><b>Software/Anbindung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PW, CFI/CFM (Farb-)Doppler-Modi</li> <li>• B-Bild in mind. 256 Graustufen</li> <li>• DICOM-Schnittstellen/DICOM-Anbindung             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Print</li> <li>– Storage</li> <li>– Worklist</li> <li>– Query / Retrieve</li> <li>– SR</li> </ul> </li> <li>• individuell einstellbare Benutzeroberfläche</li> <li>• Möglichkeit der Programmierung anwenderdefinierter Berechnungen, Piktogramme und Messfunktionen</li> <li>• Rausch- und Artefaktunterdrückung</li> <li>• Möglichkeit der Einbindung (DICOM) in das vorhandene Programm Orbis (Fa. Dedalus)</li> <li>• Möglichkeit der internen Speicherung im Falle eines IT-Ausfalls (mind. 500 GB)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einweisung des Funktionspersonals             <ul style="list-style-type: none"> <li>Dauer der Einweisung: '.....'</li> <li>Umfang der Einweisung: '.....'</li> <li>'.....'</li> <li>'.....'</li> </ul> </li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung einer KV-Meldung</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung nach EN 60601-1 ja/nein: '.....'</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE-Zeichen mit Angabe der benannten Stelle: '.....'</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferzeit ca. '.....' Wochen (max. 16 Wochen)</li> </ul> <p>Betriebssystemsoftware (deutschsprachig): '.....'</p> <p>Gerätetyp: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p>	<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

03	LV	<b>VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch</b>		
02	Titel	Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>02.2</b>	<b>Echtzeit Herzvolumenbestimmung ohne EKG-Kabel</b>	<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>02.3</b>	<b>automatische Nervenlokalisierung</b>	<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>02.4</b>	<b>automatische B-Linien-Vermessung</b>	<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>02.5</b>	<b>automatische Darstellung von Kathetergrößen für verschiedene Gefäßzugänge</b>	<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>02.6</b>	<p><b>Konvexschallkopf</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenz: '.....' MHz (mind. 2 bis 5 MHz)</li> <li>• inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals</li> </ul> <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>	<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>02.7</b>	<p><b>Linearschallkopf</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leichte Breitbandsone</li> <li>• Einsatzbereiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>– "Small Parts", Peripher Vaskular, mit Punktionshilfe</li> </ul> </li> <li>• Frequenz: '.....' MHz (mind. 6 bis 12 MHz)</li> <li>• Schallfeld: '.....' mm (mind. 34 mm)</li> <li>• wichtige Funktionen über Sondentasten bedienbar</li> <li>• inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals</li> </ul> <p>Typ: '.....'</p>			
				Übertrag: .....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
02	Titel	Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>			Übertrag: .....
		<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>02.8</b>	<p><b>Hockey-Stick 6-17 MHz</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenz: mind. 6-17 MHz</li> <li>• inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals</li> </ul> <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</li> </ul>			
		<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>02.9</b>	<p><b>Garantieverlängerung</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <p>Garantieverlängerung für max. 5 Jahre Bitte geben Sie nachfolgend die Kosten für jedes einzelne Jahr der Garantieverlängerung an:</p> <p>1. Jahr: '.....'</p> <p>2. Jahr: '.....'</p> <p>3. Jahr: '.....'</p> <p>4. Jahr: '.....'</p> <p>5. Jahr: '.....'</p>			
		<b>1 psch</b>		GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch
02	Titel	Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p><b>Wartung/Service (Information)</b></p> <p><b>Wartung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jährliche Kosten für einen Vollwartungsvertrag: '.....'</li> <li>• Wartungsturnus: '.....'</li> </ul> <p><b>Erreichbarkeit/ Verfügbarkeit</b></p> <p><b>Service/Support</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erreichbarkeit werktags: <ul style="list-style-type: none"> <li>von '.....' Uhr</li> <li>bis '.....' Uhr</li> </ul> </li> <li>• für einen Servicevertrag zu Grunde gelegte werktägliche Arbeitszeit <ul style="list-style-type: none"> <li>von '.....' Uhr</li> <li>bis '.....' Uhr</li> </ul> </li> <li>• telefonische Rückmeldung:</li> <li>• innerhalb '.....' Stunde(n)</li> <li>• Reaktionszeit Techniker vor Ort: '.....'</li> <li>• Dauer Ersatzteillieferung werktags: '.....'</li> <li>• Bemerkungen des Bieters: <ul style="list-style-type: none"> <li>'.....'</li> <li>'.....'</li> <li>'.....'</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Fernwartung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kann die Möglichkeit zur Fernwartung vorgehalten werden? <ul style="list-style-type: none"> <li>ja/nein '.....'</li> </ul> </li> <li>• Wenn ja, bitte geben Sie die Kosten pro Stunde/pro Einsatz</li> </ul>			
				Übertrag: .....

- Fortsetzung auf nächster Seite -



# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

03 02	LV Titel	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Nr.		Leistungsbeschreibung			
		an: '.....'			Übertrag: .....
		<b>Einzelkosten Instandsetzung</b>			
		• Kosten Service-Techniker pro Stunde			
		werktags: '.....' € brutto			
		Sonn-/feiertags: '.....' € brutto			
		Bemerkungen des Bieters:			
		'.....'			
		'.....'			
		'.....'			
<b>Summe Titel 02</b>					
		<b>Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal, Netto:</b>			.....

03	Titel	<b>VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch</b>		
03	Titel	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03</b>	<b>Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde</b>			
	<p><b>Vorhabenbeschreibung</b></p> <p>Im Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch soll ein Sonographiegerät für die chirurgische Sprechstunde ersetzt werden.</p> <p><b>Allgemeines</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei allen angebotenen Produkten handelt es sich um Neuware oder Demogeräte, nicht älter als sechs Monate mit allen aktuellen Prüfungen (STK)</li> <li>• alle angebotenen Komponenten sind kompatibel und dürfen zusammen betrieben werden</li> <li>• alle angegebenen Preise beinhalten die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einweisung und sämtliches Zubehör, das zum Betrieb benötigt wird</li> <li>• Die angebotenen Produkte bzw. Komponenten entsprechen den Anforderungen des Medizinproduktrecht-Durchführungsgesetz (MPDG)</li> <li>• Alle Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, Normen (wie IEC 60601-1-1, 60601-1-2, 60601-1-8) etc., die den Leistungsgegenstand betreffen, sind in ihrer gültigen Fassung zwingend einzuhalten</li> <li>• Der Bieter erfüllt die Erfordernisse der DIN EN ISO 9001</li> <li>• Der Bieter erfüllt die Erfordernisse der DIN EN ISO 13485</li> </ul> <p>Alle angebotenen Elemente, Materialien müssen für den Benutzer gesundheitlich unbedenklich sein. Beim Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln bleiben die Oberflächen mechanisch und chemisch stabil, es entstehen keine gesundheitsschädlichen Dämpfe. Bitte fügen Sie jeweils eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p> <p><b>Auswertung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Mindestanforderungen müssen erfüllt werden. Eine Nichterfüllung führt zum Ausschluss des Bieters vom weiteren Vergabeverfahren.</li> <li>• Neben den Mindestanforderungen wird in einer Probestellung die Handhabbarkeit von Soft- und Hardware des angebotenen Gerätes sowie die Bildqualität bewertet. Dieses Nutzervotum fließt ebenfalls in die Gesamtwertung ein.</li> <li>• Die Punkteverteilung und Gewichtung der einzelnen Kriterien entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bewertungsmatrix.</li> </ul> <p style="text-align: right;">Übertrag: .....</p>			

03	LV	<b>VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch</b>		
03	Titel	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>03.1</b>	<b>Grundgerät</b>			
	<b>Mindestanforderungen:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zur Durchführung von :             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Untersuchung von Abdomen, Gefäßen, oberflächennahen Weichteilen wie Schilddrüse</li> <li>– Punktionen von Gefäßen und Abszessen</li> </ul> </li> <li>• Frequenzbereich 1 MHz bis 20 MHz</li> <li>• Möglichkeit des Anschlusses von interoperativen Sonden (Schmetterlingssonde)</li> <li>• intuitive Bedienphilosophie</li> <li>• bedienbar über Touchscreen</li> <li>• Farbmonitor mind. 19" , dreh-, kipp- und schwenkbar</li> <li>• Bedienkonsole höhenverstellbar und schwenkbar</li> <li>• alle Oberflächen abwischbar und desinfizierbar</li> <li>• mind. 4 Sondenanschlüsse (parallel belegbar/verwendbar) mit weiterem Stiftsondenanschluss</li> <li>• intelligentes Kabelmanagement</li> <li>• SVHS-Ausgang</li> <li>• DVI-Anschluss</li> <li>• mind. 1 USB-Anschluss</li> <li>• Drucker (schwarz/weiß)</li> <li>• Das Gerät muss in der entsprechenden Abteilung zur Probe gestellt werden. Der Termin zur Probestellung wird über die Vergabeplattform eVergabe angefragt und vergeben. Die Probestellung muss bis zum 20. September 2024 erfolgt sein. Das Protokoll zur Probestellung ist den Ausschreibungsunterlagen beigelegt und wird vor Ort ausgefüllt. Das ausgefüllte Protokoll ist Bestandteil der Angebotsunterlagen.</li> </ul>			
	<b>Software/Anbindung</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PW, CFI/CFM (Farb-)Doppler-Modi</li> <li>• hochauflösender Farbdoppler</li> <li>• B-Bild in mind. 256 Graustufen</li> <li>• DICOM-Schnittstellen/DICOM-Anbindung             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Print</li> <li>– Store</li> <li>– Storage Commitment</li> <li>– Mortality Worklist</li> </ul> </li> <li>• Panoramabildverfahren</li> <li>• Möglichkeit der Programmierung anwenderdefinierter Berechnungen, Piktogramme und Messfunktionen</li> <li>• Rausch- und Artefaktunterdrückung</li> <li>• Möglichkeit der Einbindung (DICOM) in das vorhandene</li> </ul>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
03	Titel	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag: .....</p> <p>Programm Orbis (Fa. Dedalus)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Möglichkeit der internen Speicherung im Falle eines IT-Ausfalls (mind. 500 GB)</li> <li>Einweisung des Funktionspersonals</li> </ul> <p>Dauer der Einweisung: '.....'</p> <p>Umfang der Einweisung: '.....'</p> <p>'.....'</p> <p>'.....'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bereitstellung einer KV-Meldung</li> <li>Elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung nach EN 60601-1 ja/nein: '.....'</li> <li>CE-Zeichen mit Angabe der benannten Stelle: '.....'</li> <li>Lieferzeit ca. '.....' Wochen (max. 16 Wochen)</li> </ul> <p>Betriebssystemsoftware (deutschsprachig): '.....'</p> <p>Gerätetyp: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p>	1 St	EP.....	GP .....
<b>03.2</b>	<p><b>Linearschallkopf 9 MHz</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Frequenz: '.....' MHz (9 MHz)</li> <li>für Gefäßuntersuchungen (Bein-, Halsgefäße)</li> <li>inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals</li> </ul> <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>	1 St	EP.....	GP .....
	Übertrag: .....			

# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

03	LV	<b>VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch</b>		
03	Titel	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>03.3</b>	<p><b>Konvexschallkopf 3-5 MHz</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenz: '.....' MHz (3-5 MHz)</li> <li>• inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals</li> </ul> <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>	<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>03.4</b>	<p><b>Stiftsonde 8 MHz</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenz: 8 MHz</li> <li>• inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals</li> </ul> <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>	<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>03.5</b>	<p><b>interoperativer Schallkopf (Schmetterlingssonde) 3-9 MHz</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenz: ca. 3-9 MHz</li> <li>• inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals</li> </ul> <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>	<b>1 St</b>	EP.....	- Nur EP -
				Übertrag: .....

\*\*\*Bedarfspos.

# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

03	LV	<b>VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch</b>		
03	Titel	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	***Bedarfspos.			
03.6	<p><b>Hockey-Stick-Sonde</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für interoperative Gefäßanwendung</li> <li>• inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals</li> </ul> <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</li> </ul>	1 St	EP.....	- Nur EP -
03.7	<p><b>Garantieverlängerung</b></p> <p><b>Mindestanforderungen:</b></p> <p>Garantieverlängerung für max. 5 Jahre Bitte geben Sie nachfolgend die Kosten für jedes einzelne Jahr der Garantieverlängerung an:</p> <p>1. Jahr: '.....'</p> <p>2. Jahr: '.....'</p> <p>3. Jahr: '.....'</p> <p>4. Jahr: '.....'</p> <p>5. Jahr: '.....'</p>	1 psch		GP .....
	<p><b>Wartung/Service (Information)</b></p> <p><b>Wartung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jährliche Kosten für einen Vollwartungsvertrag: '.....'</li> </ul> <p>Wartungsturnus: '.....'</p> <p><b>Erreichbarkeit/ Verfügbarkeit</b></p> <p><b>Service/Support</b></p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch
03	Titel	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erreichbarkeit werktags:                von '.....' Uhr                bis '.....' Uhr</li> <li>• für einen Servicevertrag zu Grunde gelegte werktägliche Arbeitszeit                von '.....' Uhr                bis '.....' Uhr</li> <li>• telefonische Rückmeldung:</li> <li>• innerhalb '.....' Stunde(n)</li> <li>• Reaktionszeit Techniker vor Ort: '.....'</li> <li>• Dauer Ersatzteillieferung werktags: '.....'</li> <li>• Bemerkungen des Bieters:                '.....'                '.....'                '.....'</li> </ul>			
	<p><b>Fernwartung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kann die Möglichkeit zur Fernwartung vorgehalten werden?                ja/nein '.....'</li> <li>• Wenn ja, bitte geben Sie die Kosten pro Stunde/pro Einsatz an: '.....'</li> </ul>			
	<p><b>Einzelkosten Instandsetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kosten Service-Techniker pro Stunde                werktags: '.....' € brutto                sonn-/feiertags: '.....' € brutto</li> <li>• Bemerkungen des Bieters:                '.....'                '.....'</li> </ul>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch</b>		
03	Titel	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	'.....'			
<b>Summe Titel 03</b>				
			<b>Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde, Netto:</b>	.....



# LV-Zusammenfassung

KOGRowi\_Sonographie (K237186)

<b>03 LV VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch</b>				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugend...</b>	3	.....
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal</b>	11	.....
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde</b>	18	.....
<b>Summe LV 03 VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Oberg...</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				