


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

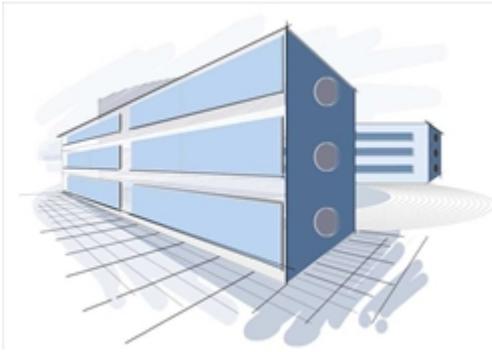

Projekt

K237186_KOGRowi_Sonographie

Bauvorhaben

KOR07/2024

Ersatzbeschaffung Ultraschallgeräte KOG

-

-

Leistung (LV)

03

VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes auf der Vergabeplattform.

Vergabevorgang (Art der Ausschreibung)

Ausschreibung nach VOL/A

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 25

Leistungsverzeichnis BM 1 Seite

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Angebotssumme, Brutto:

Angebotsabgabe

.....
Anbieter - Datum, Ort

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.

Inhaltsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03 LV VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin	3
02	Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal	11
03	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde	18
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	25

03 01	Titel	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	<p>Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin</p> <p>Vorhabenbeschreibung Im Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch soll ein Sonographiegerät in der Kinderklinik ersetzt werden.</p> <p>Allgemeines</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei allen angebotenen Produkten handelt es sich um Neuware oder Demogeräte, nicht älter als sechs Monate mit allen aktuellen Prüfungen (STK) • alle angebotenen Komponenten sind kompatibel und dürfen zusammen betrieben werden • alle angegebenen Preise beinhalten die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einweisung und sämtliches Zubehör, das zum Betrieb benötigt wird • Die angebotenen Produkte bzw. Komponenten entsprechen den Anforderungen des Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG) • Alle Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, Normen (wie IEC 60601-1-1, 60601-1-2, 60601-1-8) etc., die den Leistungsgegenstand betreffen, sind in ihrer gültigen Fassung zwingend einzuhalten • Der Bieter erfüllt die Erfordernisse der DIN EN ISO 9001 • Der Bieter erfüllt die Erfordernisse der DIN EN ISO 13485 <p>Alle angebotenen Elemente, Materialien müssen für den Benutzer gesundheitlich unbedenklich sein. Beim Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln bleiben die Oberflächen mechanisch und chemisch stabil, es entstehen keine gesundheitsschädlichen Dämpfe. Bitte fügen Sie jeweils eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p> <p>Auswertung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Mindestanforderungen müssen erfüllt werden. Eine Nichterfüllung führt zum Ausschluss des Bieters vom weiteren Vergabeverfahren. • Neben den Mindestanforderungen wird in einer Probestellung die Handhabbarkeit von Soft- und Hardware des angebotenen Gerätes sowie die Bildqualität bewertet. Dieses Nutzervotum fließt ebenfalls in die Gesamtwertung ein. • Die Punkteverteilung und Gewichtung der einzelnen Kriterien entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bewertungsmatrix. 			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
01	Titel	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.1	<p>Grundgerät</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chirurgie • Pädiatrie/Kinderdiagnostik: <ul style="list-style-type: none"> – offene Fontanelle – Säuglingshüfte – Herzuntersuchungen – oberflächliche Weichteile – Abdomen – Harntrakt – Refluxdiagnostik/ Kontrast • mobil/fahrbar <ul style="list-style-type: none"> – geräuscharme Räder – zwei feststellbare Räder • digitales, hochauflösendes RealTime-Triplex-System • intuitive Bedienphilosophie: Bedienoberfläche ist mit einer aktuellen Windowsoberfläche vergleichbar • mind. Windows 10 embedded System • bedienbar über Touchscreen und Hardkeys • ergonomische Bedienkonsole höhenverstellbar und schwenkbar • alle Oberflächen abwischbar und desinfizierbar • mind. 4 Sondenanschlüsse (parallel belegbar/verwendbar) und einen Stiftsondenanschluss • Gelwärmer • hochauflösender Farbmonitor (mind. 21") <ul style="list-style-type: none"> – Größe des Farbmonitors: '.....' " • EKG (mind. 3 Ableitungen) • SVHS-Ausgang • DVI-Anschluss • mind. 1 USB-Anschluss • Drucker (schwarz/weiß) • WLAN-fähig • Akkubetrieb zur Pufferung bei Standortwechsel des Gerätes innerhalb der Station • Das Gerät muss in der entsprechenden Abteilung zur Probe gestellt werden. Der Termin zur Probestellung wird über die Vergabeplattform eVergabe angefragt und vergeben. Die Probestellung muss bis zum 22.November 2024 erfolgt sein. Das Protokoll zur Probestellung ist den Ausschreibungsunterlagen beigefügt und wird vor Ort ausgefüllt. Das ausgefüllte Protokoll ist Bestandteil der Angebotsunterlagen. <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
01	Titel	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Software/Anbindung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Power-Doppler • PW, CFI/CFM (Farb-)Doppler-Modi • automatische Dopplerkalkulation • B-Bild in mind. 256 Graustufen • Abtastformate: <ul style="list-style-type: none"> – Parallel Scan – Convex Scan – Sektor Scan – Trapez Scan – Panorama Scan • Schallkopftechniken: <ul style="list-style-type: none"> – linear array – convex array – sector phased array • DICOM-Schnittstellen/DICOM-Anbindung <ul style="list-style-type: none"> – Print – Storage – Worklist – Query / Retrieve – SR • Applikationsspezifische Bildeinstellungen • Möglichkeit der Programmierung anwenderdefinierter Berechnungen, Piktogramme und Messfunktionen für die genannten medizinischen Bereiche • Möglichkeit einen Barcodescanner anzuschließen • Rausch- und Artefaktunterdrückung <ul style="list-style-type: none"> – automatische Gewebeoptimierung – automatische Farboptimierung – automatische Dopplerspektrumoptimierung • Möglichkeit der Einbindung (DICOM) in das vorhandene Programm Orbis (Fa. Dedalus) • integriertes digitales Patientenarchiv • Bilddaten sind für Nachuntersuchungen schnell erreichbar und können retrospektiv optimiert werden • Möglichkeit der internen Speicherung von Einzelbildern und Bildfolgen im Falle eines IT-Ausfalls (mind. 500 GB) <p>Notwendiges Zubehör (z.B. spezielle Sondenhalter) ist für alle obligatorisch angefragten Positionen mitzuliefern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einweisung des Funktionspersonals <p style="margin-left: 40px;">Dauer der Einweisung: '.....'</p> <p style="margin-left: 40px;">Umfand der Einweisung: '.....'</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
01	Titel	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung einer KV-Meldung • Elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung nach EN 60601-1 ja/nein: '.....' • CE-Zeichen mit Angabe der benannten Stelle: '.....' • Lieferzeit ca. '.....' Wochen (max. 16 Wochen) <p>Betriebssystemsoftware (deutschsprachig): '.....'</p> <p>Gerätetyp: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p>	1 St	EP.....	GP
01.2	<p>Fußschalter</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fußschalter zur Bedienung während einer Untersuchung von Säuglingen 	1 St	EP.....	- Nur EP -
01.3	<p>Linearschallkopf 11 MHz</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frequenz: 11 MHz • inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei. 	1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch
01	Titel	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.4	<p>Mikrokonvex - Schallkopf 3-10 MHz</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frequenz 3-10 MHz • inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals • für Abdomen und Fontanelle <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>	1 St	EP.....	GP
01.5	<p>Convexschallkopf 3-5 MHz</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frequenz 3-5 MHz • inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>	1 St	EP.....	GP
01.6	<p>Sektorschallkopf groß 3-5 MHz</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frequenz 3-5MHz • inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals <p>Typ: '.....'</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
01	Titel	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hersteller: '.....'			
	Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.			
		1 St	EP.....	GP
01.7	Sektorschallkopf klein 10-12 MHz			
	Mindestanforderungen:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenz 10-12 MHz • inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals • für Untersuchungen der Fontanelle geeignet 			
	Typ: '.....'			
	Hersteller: '.....'			
	Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.			
		1 St	EP.....	GP
	***Bedarfspos.			
01.8	Hockey-Stick Schallkopf 10-18 MHz			
	Mindestanforderungen:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenz: 10 - 18 MHz • für Untersuchungen im Inkubator • inkl. Lieferung, Installatin und Einweisung des Funktionspersonals 			
	Typ: '.....'			
	Hersteller: '.....'			
	Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.			
		1 St	EP.....	- Nur EP -
01.9	Garantieverlängerung			
	Mindestanforderungen:			
	Garantieverlängerung für max. 5 Jahre Bitte geben Sie nachfolgend die Kosten für jedes einzelne Jahr			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
01	Titel	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	der Garantieverlängerung an:			
	1. Jahr: '.....'			
	2. Jahr: '.....'			
	3. Jahr: '.....'			
	4. Jahr: '.....'			
	5. Jahr: '.....'			
		1 psch		GP
	Wartung/Service (Information)			
	Wartung:			
	• jährliche Kosten für einen Vollwartungsvertrag: '.....'			
	• Wartungsturnus: '.....'			
	Erreichbarkeit/ Verfügbarkeit			
	Service/Support			
	• Erreichbarkeit werktags:			
	von '.....' Uhr			
	bis '.....' Uhr			
	• für einen Servicevertrag zu Grunde gelegte werktägliche Arbeitszeit			
	von '.....' Uhr			
	bis '.....' Uhr			
	• telefonische Rückmeldung:			
	• innerhalb '.....' Stunde(n)			
	• Reaktionszeit Techniker vor Ort: '.....'			
	• Dauer Ersatzteillieferung werktags: '.....'			
	• Bemerkungen des Bieters:			
	'.....'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
01	Titel	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p style="text-align: center;">'.....'</p> <p style="text-align: center;">'.....'</p> <p>Fernwartung</p> <ul style="list-style-type: none"> Kann die Möglichkeit zur Fernwartung vorgehalten werden? <p>ja/nein '.....'</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn ja, bitte geben Sie die Kosten pro Stunde/pro Einsatz an: '.....' <p>Einzelkosten Instandsetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> Kosten Service-Techniker pro Stunde <p>werktags: '.....' € brutto</p> <p>Sonn-/feiertags: '.....' € brutto</p> <p>Bemerkungen des Bieters:</p> <p>'.....'</p> <p>'.....'</p> <p>'.....'</p>			
Summe Titel 01		Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugendmedizin, Netto:		

03	Titel	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
02	Titel	Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal			
	<p>Vorhabenbeschreibung</p> <p>Im Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch soll ein Sonographiegerät für die Anästhesie des OP-Saals ersetzt werden.</p> <p>Allgemeines</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei allen angebotenen Produkten handelt es sich um Neuware oder Demogeräte, nicht älter als sechs Monate mit allen aktuellen Prüfungen (STK) • alle angebotenen Komponenten sind kompatibel und dürfen zusammen betrieben werden • alle angegebenen Preise beinhalten die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einweisung und sämtliches Zubehör, das zum Betrieb benötigt wird • Die angebotenen Produkte bzw. Komponenten entsprechen den Anforderungen des Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG) • Alle Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, Normen (wie IEC 60601-1-1, 60601-1-2, 60601-1-8) etc., die den Leistungsgegenstand betreffen, sind in ihrer gültigen Fassung zwingend einzuhalten • Der Bieter erfüllt die Erfordernisse der DIN EN ISO 9001 • Der Bieter erfüllt die Erfordernisse der DIN EN ISO 13485 <p>Alle angebotenen Elemente, Materialien müssen für den Benutzer gesundheitlich unbedenklich sein. Beim Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln bleiben die Oberflächen mechanisch und chemisch stabil, es entstehen keine gesundheitsschädlichen Dämpfe. Bitte fügen Sie jeweils eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p> <p>Auswertung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Mindestanforderungen müssen erfüllt werden. Eine Nichterfüllung führt zum Ausschluss des Bieters vom weiteren Vergabeverfahren. • Neben den Mindestanforderungen wird in einer Probestellung die Handhabbarkeit von Soft- und Hardware des angebotenen Gerätes sowie die Bildqualität bewertet. 			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03 02	LV Titel	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Dieses Nutzervotum fließt ebenfalls in die Gesamtwertung ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Punkteverteilung und Gewichtung der einzelnen Kriterien entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bewertungsmatrix. 				Übertrag:
02.1	<p>Grundgerät</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> zur Durchführung von Untersuchungen an : <ul style="list-style-type: none"> peripheren Nerven Venen-/Arterien Abdomen Echo-/Echo TEE Frequenzbereich 1 MHz bis 20 MHz mobil/fahrbar für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen OP-Räumen der Station <ul style="list-style-type: none"> mit geräuscharmen Rädern mind. zwei Räder feststellbar interner Akku mit mind. 1,5 h Laufzeit bei Schallaktivität Laufzeit des Akkus: '.....' h digitales Farbtuplex-System intuitive Bedienphilosophie tiefenabhängige Steuerung der Sondenfrequenz vorhanden Farbmonitor/Touchscreen mind. 17" , dreh-, und kippbar ergonomische Bedienkonsole höhenverstellbar Sonden möglichst weit oben angebracht alle Oberflächen abwischbar und desinfizierbar mind. 3 Sondenanschlüsse (parallel belegbar/verwendbar) intelligentes Kabelmanagement mind. 1 USB-Anschluss Drucker (schwarz/weiß) Das Gerät muss in der entsprechenden Abteilung zur Probe gestellt werden. Der Termin zur Probestellung wird über die Vergabeplattform eVergabe angefragt und vergeben. Die Probestellung muss bis zum 22. November 2024 erfolgt sein. Das Protokoll zur Probestellung ist den Ausschreibungsunterlagen beigelegt und wird vor Ort ausgefüllt. Das ausgefüllte Protokoll ist Bestandteil der Angebotsunterlagen. <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
02	Titel	Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Software/Anbindung</p> <ul style="list-style-type: none"> • PW, CFI/CFM (Farb-)Doppler-Modi • B-Bild in mind. 256 Graustufen • DICOM-Schnittstellen/DICOM-Anbindung <ul style="list-style-type: none"> – Print – Storage – Worklist – Query / Retrieve – SR • individuell einstellbare Benutzeroberfläche • Möglichkeit der Programmierung anwenderdefinierter Berechnungen, Piktogramme und Messfunktionen • Rausch- und Artefaktunterdrückung • Möglichkeit der Einbindung (DICOM) in das vorhandene Programm Orbis (Fa. Dedalus) • Möglichkeit der internen Speicherung im Falle eines IT-Ausfalls (mind. 500 GB) <ul style="list-style-type: none"> • Einweisung des Funktionspersonals <ul style="list-style-type: none"> Dauer der Einweisung: '.....' Umfang der Einweisung: '.....' '.....' '.....' <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung einer KV-Meldung <ul style="list-style-type: none"> • Elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung nach EN 60601-1 ja/nein: '.....' <ul style="list-style-type: none"> • CE-Zeichen mit Angabe der benannten Stelle: '.....' <ul style="list-style-type: none"> • Lieferzeit ca. '.....' Wochen (max. 16 Wochen) <p>Betriebssystemsoftware (deutschsprachig): '.....'</p> <p>Gerätetyp: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p>	1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
02	Titel	Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.2	Echtzeit Herzvolumenbestimmung ohne EKG-Kabel	1 St	EP.....	GP
02.3	automatische Nervenlokalisierung	1 St	EP.....	GP
02.4	automatische B-Linien-Vermessung	1 St	EP.....	GP
02.5	automatische Darstellung von Kathetergrößen für verschiedene Gefäßzugänge	1 St	EP.....	GP
02.6	<p>Konvexschallkopf</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frequenz: '.....' MHz (mind. 2 bis 5 MHz) • inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>	1 St	EP.....	GP
02.7	<p>Linearschallkopf</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • leichte Breitbandsone • Einsatzbereiche: <ul style="list-style-type: none"> – "Small Parts", Peripher Vaskular, mit Punktionshilfe • Frequenz: '.....' MHz (mind. 6 bis 12 MHz) • Schallfeld: '.....' mm (mind. 34 mm) • wichtige Funktionen über Sondentasten bedienbar • inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals <p>Typ: '.....'</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
02	Titel	Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>			Übertrag:
		1 St	EP.....	GP
02.8	<p>Hockey-Stick 6-17 MHz</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frequenz: mind. 6-17 MHz • inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei. 			
		1 St	EP.....	GP
02.9	<p>Garantieverlängerung</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <p>Garantieverlängerung für max. 5 Jahre Bitte geben Sie nachfolgend die Kosten für jedes einzelne Jahr der Garantieverlängerung an:</p> <p>1. Jahr: '.....'</p> <p>2. Jahr: '.....'</p> <p>3. Jahr: '.....'</p> <p>4. Jahr: '.....'</p> <p>5. Jahr: '.....'</p>			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch
02	Titel	Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Wartung/Service (Information)</p> <p>Wartung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jährliche Kosten für einen Vollwartungsvertrag: '.....' • Wartungsturnus: '.....' <p>Erreichbarkeit/ Verfügbarkeit</p> <p>Service/Support</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erreichbarkeit werktags: <ul style="list-style-type: none"> von '.....' Uhr bis '.....' Uhr • für einen Servicevertrag zu Grunde gelegte werktägliche Arbeitszeit <ul style="list-style-type: none"> von '.....' Uhr bis '.....' Uhr • telefonische Rückmeldung: • innerhalb '.....' Stunde(n) • Reaktionszeit Techniker vor Ort: '.....' • Dauer Ersatzteillieferung werktags: '.....' • Bemerkungen des Bieters: <ul style="list-style-type: none"> '.....' '.....' '.....' <p>Fernwartung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kann die Möglichkeit zur Fernwartung vorgehalten werden? <ul style="list-style-type: none"> ja/nein '.....' • Wenn ja, bitte geben Sie die Kosten pro Stunde/pro Einsatz 			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03 02	LV Titel	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>an: '.....'</p> <p>Einzelkosten Instandsetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kosten Service-Techniker pro Stunde <p>werktags: '.....' € brutto</p> <p>Sonn-/feiertags: '.....' € brutto</p> <p>Bemerkungen des Bieters:</p> <p>'.....'</p> <p>'.....'</p> <p>'.....'</p>				Übertrag:
Summe Titel 02		Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal, Netto:		

03	Titel	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
03	Titel	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde			
	<p>Vorhabenbeschreibung</p> <p>Im Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch soll ein Sonographiegerät für die chirurgische Sprechstunde ersetzt werden.</p> <p>Allgemeines</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei allen angebotenen Produkten handelt es sich um Neuware oder Demogeräte, nicht älter als sechs Monate mit allen aktuellen Prüfungen (STK) • alle angebotenen Komponenten sind kompatibel und dürfen zusammen betrieben werden • alle angegebenen Preise beinhalten die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einweisung und sämtliches Zubehör, das zum Betrieb benötigt wird • Die angebotenen Produkte bzw. Komponenten entsprechen den Anforderungen des Medizinproduktrecht-Durchführungsgesetz (MPDG) • Alle Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, Normen (wie IEC 60601-1-1, 60601-1-2, 60601-1-8) etc., die den Leistungsgegenstand betreffen, sind in ihrer gültigen Fassung zwingend einzuhalten • Der Bieter erfüllt die Erfordernisse der DIN EN ISO 9001 • Der Bieter erfüllt die Erfordernisse der DIN EN ISO 13485 <p>Alle angebotenen Elemente, Materialien müssen für den Benutzer gesundheitlich unbedenklich sein. Beim Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln bleiben die Oberflächen mechanisch und chemisch stabil, es entstehen keine gesundheitsschädlichen Dämpfe. Bitte fügen Sie jeweils eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p> <p>Auswertung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Mindestanforderungen müssen erfüllt werden. Eine Nichterfüllung führt zum Ausschluss des Bieters vom weiteren Vergabeverfahren. • Neben den Mindestanforderungen wird in einer Probestellung die Handhabbarkeit von Soft- und Hardware des angebotenen Gerätes sowie die Bildqualität bewertet. Dieses Nutzervotum fließt ebenfalls in die Gesamtwertung ein. • Die Punkteverteilung und Gewichtung der einzelnen Kriterien entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bewertungsmatrix. 			
				Übertrag:

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
03	Titel	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.1	Grundgerät			
	Mindestanforderungen:			
	<ul style="list-style-type: none"> • High-End-Gerät zur Durchführung von : <ul style="list-style-type: none"> – Untersuchung von Abdomen, Gefäßen, oberflächennahen Weichteilen wie Schilddrüse – Punktionen von Gefäßen und Abszessen – Kontrastmittelgestützte Ultraschallkontrolle: hochauflösende Kontrastmitteldarstellung für Endoleak-Kontrolle inklusive Mikrovaskulation, wenn möglich B-Bild plus Verfahren • Frequenzbereich 1 MHz bis 20 MHz • Möglichkeit des Anschlusses von interoperativen Sonden (Schmetterlingssonde) • intuitive Bedienphilosophie • bedienbar über Touchscreen • Farbmonitor mind. 19" , dreh-, kipp- und schwenkbar • Bedienkonsole höhenverstellbar und schwenkbar • alle Oberflächen abwischbar und desinfizierbar • mind. 4 Sondenanschlüsse (parallel belegbar/verwendbar) mit weiterem Stiftsondenanschluss • intelligentes Kabelmanagement • SVHS-Ausgang • DVI-Anschluss • mind. 1 USB-Anschluss • Drucker (schwarz/weiß) • Das Gerät muss in der entsprechenden Abteilung zur Probe gestellt werden. Der Termin zur Probestellung wird über die Vergabeplattform eVergabe angefragt und vergeben. Die Probestellung muss bis zum 22. November 2024 erfolgt sein. Das Protokoll zur Probestellung ist den Ausschreibungsunterlagen beigelegt und wird vor Ort ausgefüllt. Das ausgefüllte Protokoll ist Bestandteil der Angebotsunterlagen. 			
	Software/Anbindung			
	<ul style="list-style-type: none"> • PW, CFI/CFM (Farb-)Doppler-Modi • hochauflösender Farbdoppler • B-Bild in mind. 256 Graustufen • DICOM-Schnittstellen/DICOM-Anbindung <ul style="list-style-type: none"> – Print – Store – Storage Commitment – Mortality Worklist • Panoramabildverfahren 			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
03	Titel	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeit der Programmierung anwenderdefinierter Berechnungen, Piktogramme und Messfunktionen • Rausch- und Artefaktunterdrückung • Möglichkeit der Einbindung (DICOM) in das vorhandene Programm Orbis (Fa. Dedalus) • Möglichkeit der internen Speicherung im Falle eines IT-Ausfalls (mind. 500 GB) • Einweisung des Funktionspersonals Dauer der Einweisung: '.....' Umfang der Einweisung: '.....' '.....' '.....' • Bereitstellung einer KV-Meldung • Elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung nach EN 60601-1 ja/nein: '.....' • CE-Zeichen mit Angabe der benannten Stelle: '.....' • Lieferzeit ca. '.....' Wochen (max. 16 Wochen) Betriebssystemsoftware (deutschsprachig): '.....' Gerätetyp: '.....' Hersteller: '.....' 	1 St	EP.....	GP
03.2	<p>Linearschallkopf 9 MHz</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frequenz: '.....' MHz (9 MHz) • für Gefäßuntersuchungen (Bein-, Halsgefäße) • inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals <p>Typ: '.....'</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
03	Titel	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>	1 St	EP.....	GP
03.3	<p>Konvexschallkopf 3-5 MHz</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frequenz: '.....' MHz (3-5 MHz) • inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>	1 St	EP.....	GP
03.4	<p>Stiftsonde 8 MHz</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frequenz: 8 MHz • inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals <p>Typ: '.....'</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <p>Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.</p>	1 St	EP.....	GP
03.5	<p>interoperativer Schallkopf (Schmetterlingssonde) 3-9 MHz</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frequenz: ca. 3-9 MHz • inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals 	1 St	EP.....	GP
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

***Bedarfspos.

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
03	Titel	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Typ: '.....' Hersteller: '.....' Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei.			Übertrag:
		1 St	EP.....	- Nur EP -
03.6	Hockey-Stick-Sonde Mindestanforderungen: <ul style="list-style-type: none"> • für interoperative Gefäßanwendung • inkl. Lieferung, Installation und Einweisung des Funktionspersonals Typ: '.....' Hersteller: '.....' <ul style="list-style-type: none"> • Bitte fügen Sie eine Liste mit verwendbaren Desinfektionsmitteln sowie empfohlenen Reinigungsprozeduren bei. 			
		1 St	EP.....	- Nur EP -
03.7	Garantieverlängerung Mindestanforderungen: Garantieverlängerung für max. 5 Jahre Bitte geben Sie nachfolgend die Kosten für jedes einzelne Jahr der Garantieverlängerung an:			
	1. Jahr: '.....' 2. Jahr: '.....' 3. Jahr: '.....' 4. Jahr: '.....' 5. Jahr: '.....'			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
03	Titel	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Wartung/Service (Information)			
	Wartung:			
	• jährliche Kosten für einen Vollwartungsvertrag: '.....'			
	Wartungsturnus: '.....'			
	Erreichbarkeit/ Verfügbarkeit			
	Service/Support			
	• Erreichbarkeit werktags:			
	von '.....' Uhr			
	bis '.....' Uhr			
	• für einen Servicevertrag zu Grunde gelegte werktägliche Arbeitszeit			
	von '.....' Uhr			
	bis '.....' Uhr			
	• telefonische Rückmeldung:			
	• innerhalb '.....' Stunde(n)			
	• Reaktionszeit Techniker vor Ort: '.....'			
	• Dauer Ersatzteillieferung werktags: '.....'			
	• Bemerkungen des Bieters:			
	'.....'			
	'.....'			
	'.....'			
	Fernwartung			
	• Kann die Möglichkeit zur Fernwartung vorgehalten werden?			
	ja/nein '.....'			
	• Wenn ja, bitte geben Sie die Kosten pro Stunde/pro Einsatz			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03	LV	VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch		
03	Titel	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>an: '.....'</p> <p>Einzelkosten Instandsetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kosten Service-Techniker pro Stunde <p>werktags: '.....' € brutto</p> <p>sonn-/feiertags: '.....' € brutto</p> <p>Bemerkungen des Bieters:</p> <p>'.....'</p> <p>'.....'</p> <p>'.....'</p>			Übertrag:
Summe Titel 03		Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde, Netto:		

LV-Zusammenfassung

KOGRowi_Sonographie (K237186)

03 LV VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Obergöltzsch					
Nr.	Bezeichnung			Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Ultraschallgerät für die Klinik der Kinder- und Jugend...		3
02	Titel	Ultraschallgerät für Anästhesie im OP-Saal		11
03	Titel	Ultraschallgerät für die chirurgische Sprechstunde		18
Summe LV 03 VE.03 drei Ultraschallgeräte für das Klinikum Oberg...					
				Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel				zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....				<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift					