



Labor-Nr.: 18-022644-01

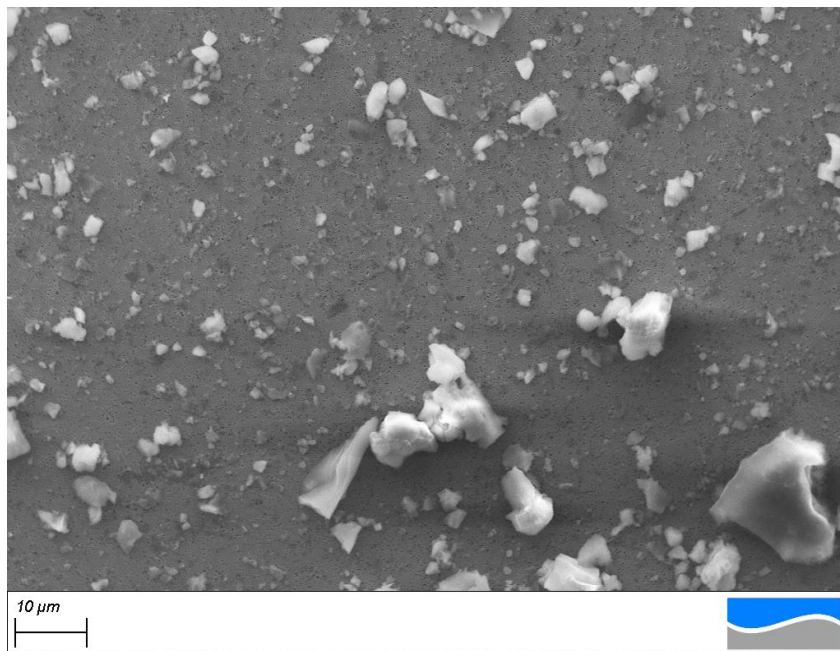


Rasterelektronenmikroskopische Abbildung:
Belegung des Filters

Labor-Nr.: 18-022644-02

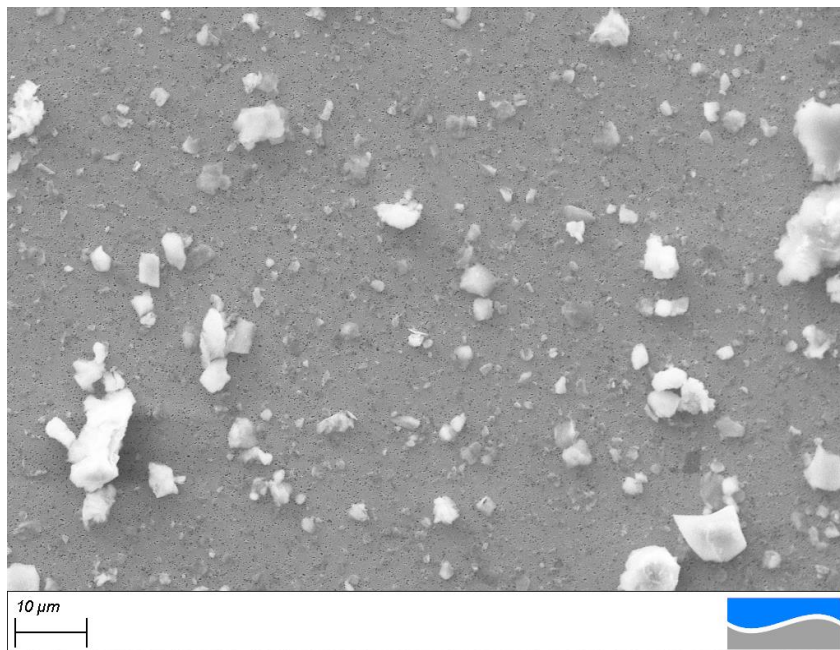


Rasterelektronenmikroskopische Abbildung:
Belegung des Filters

Labor-Nr.: 18-022644-03

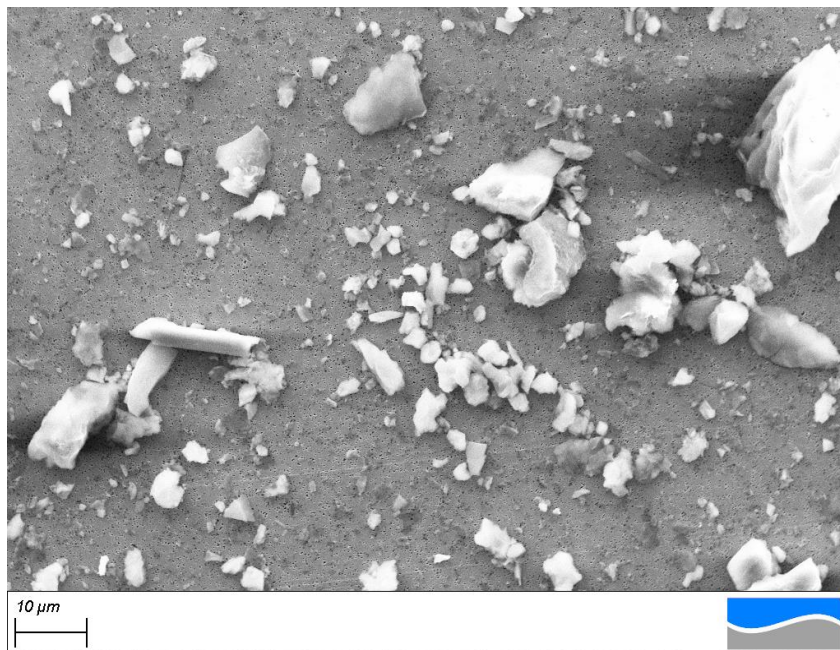


Rasterelektronenmikroskopische Abbildung:
Belegung des Filters

Labor-Nr.: 18-022644-04

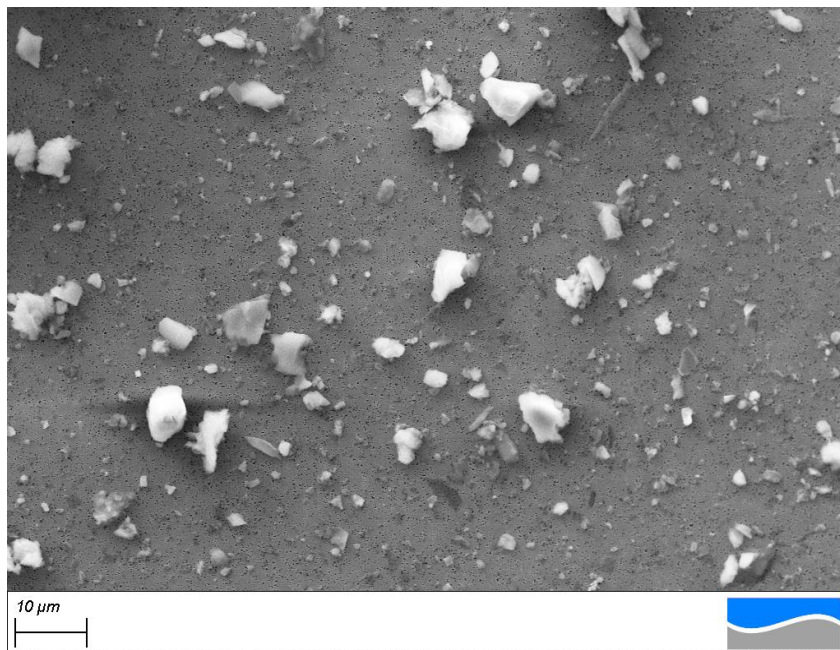


Rasterelektronenmikroskopische Abbildung:
Belegung des Filters

Labor-Nr.: 18-022644-05

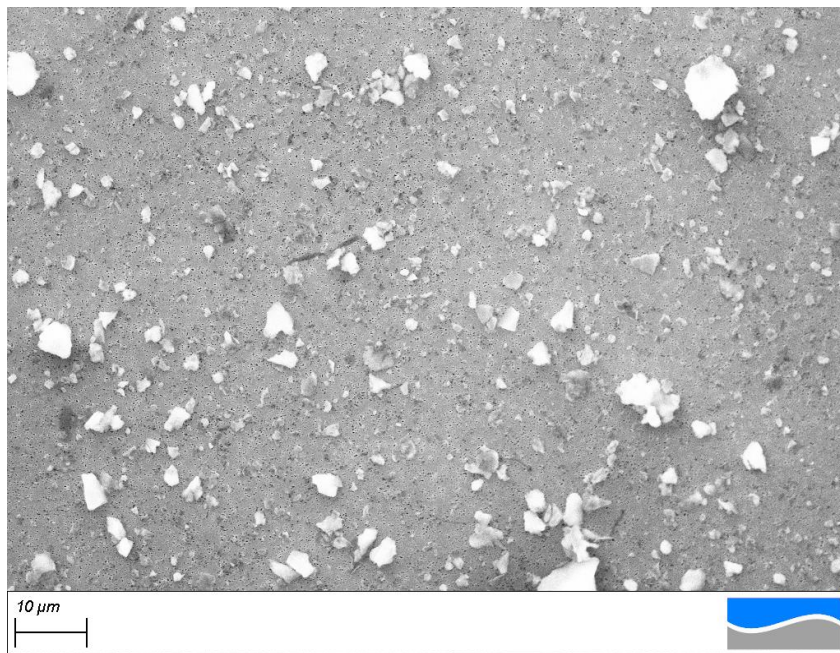


Rasterelektronenmikroskopische Abbildung:
Belegung des Filters

Labor-Nr.: 18-022644-06

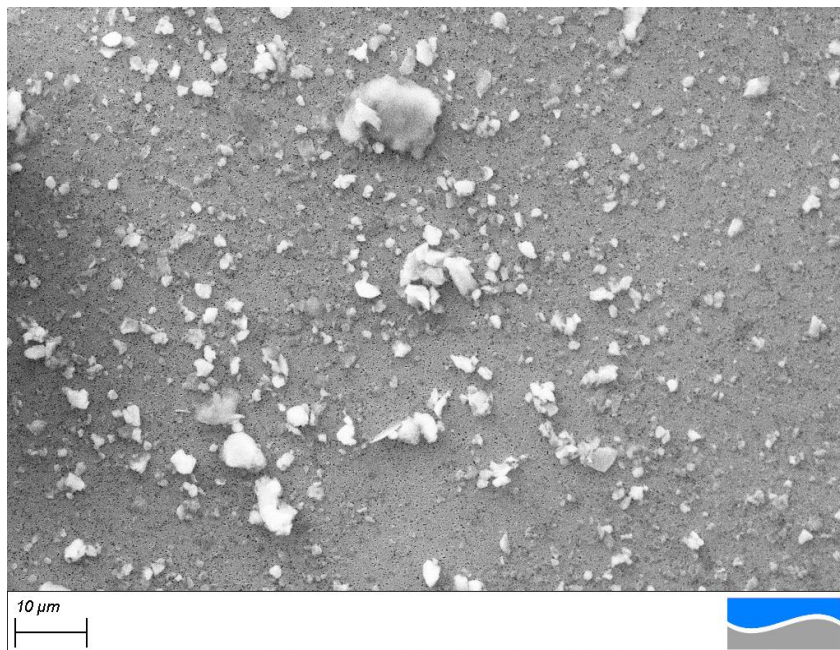

Rasterelektronenmikroskopische Abbildung:
Belegung des Filters

Labor-Nr.: 18-022644-07

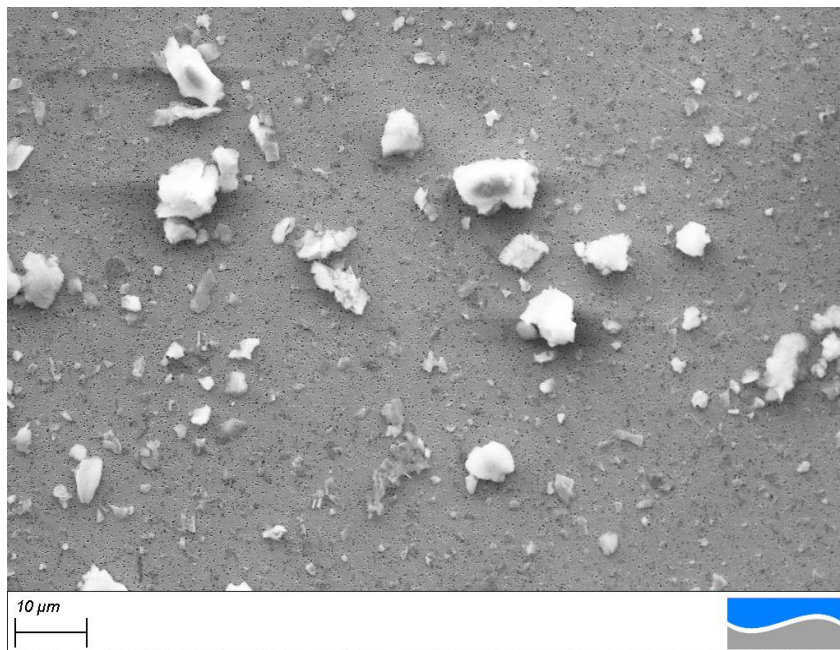

Rasterelektronenmikroskopische Abbildung:
Belegung des Filters

Labor-Nr.: 18-022644-08



Rasterelektronenmikroskopische Abbildung:
Belegung des Filters